


Утверждаю: \_\_\_\_\_  
Главный метролог ООО «ИВК-Саяны»

  
подпись \_\_\_\_\_  
Епишкин П.В.  
расшифровка

Акт №04 от «17» января 2018 г.

**Калибровка измерителя ИНДИВИД (регистрационный номер 51791-12 в Государственном реестре средств измерений)  
для определения поправочного коэффициента соответствующего модели отопительного прибора  
в соответствии с описанием типа средства измерения и методикой калибровки**

Данные отопительного прибора:


Производитель: Закрытое акционерное общество "РИФАР"  
Почтовый адрес: 462630, г. Гай, Оренбургской обл., Технологический проезд, 18  
Телефон: (35362) 45-113  
Факс: (35362) 45-104  
E-mail: info@rifar.ru

Модель: Rifar BASE 500

Дата испытания: 17.01.2018

Средства испытания: Установка калибровки измерителей УИ-07

Крепление измерителя: 75% высоты отопительного прибора от нижнего края, КМЧ №1.  
(Схема крепления измерителя приведена в Приложении А к настоящему документу)

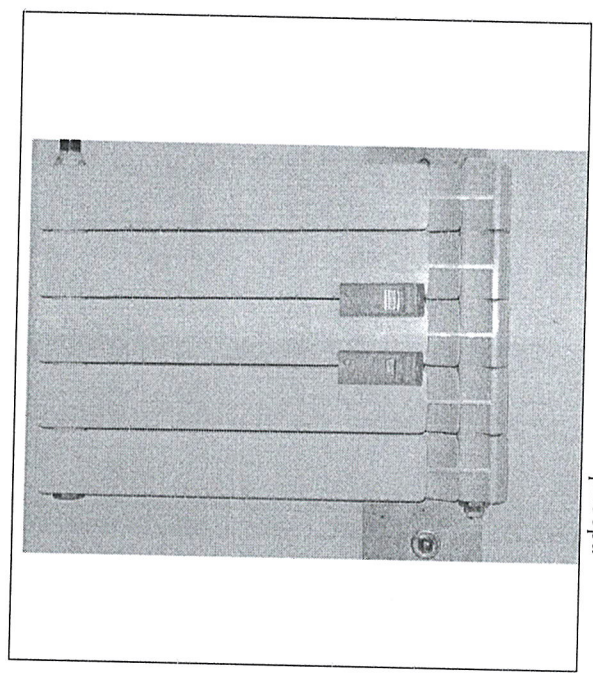


Фотография отопительного прибора


**Результаты испытаний**

Значение коэффициента к для отопительных приборов Rifar BASE 500 для измерителей ИНДИВИД-2 и ИНДИВИД-2 РМД составляет 0,156.

Ответственный за калибровку:

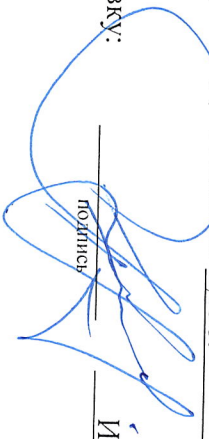  
подпись

Иванов А.А.  
расшифровка



Дата: 17.01.2018г.

**Схема подключения**

